



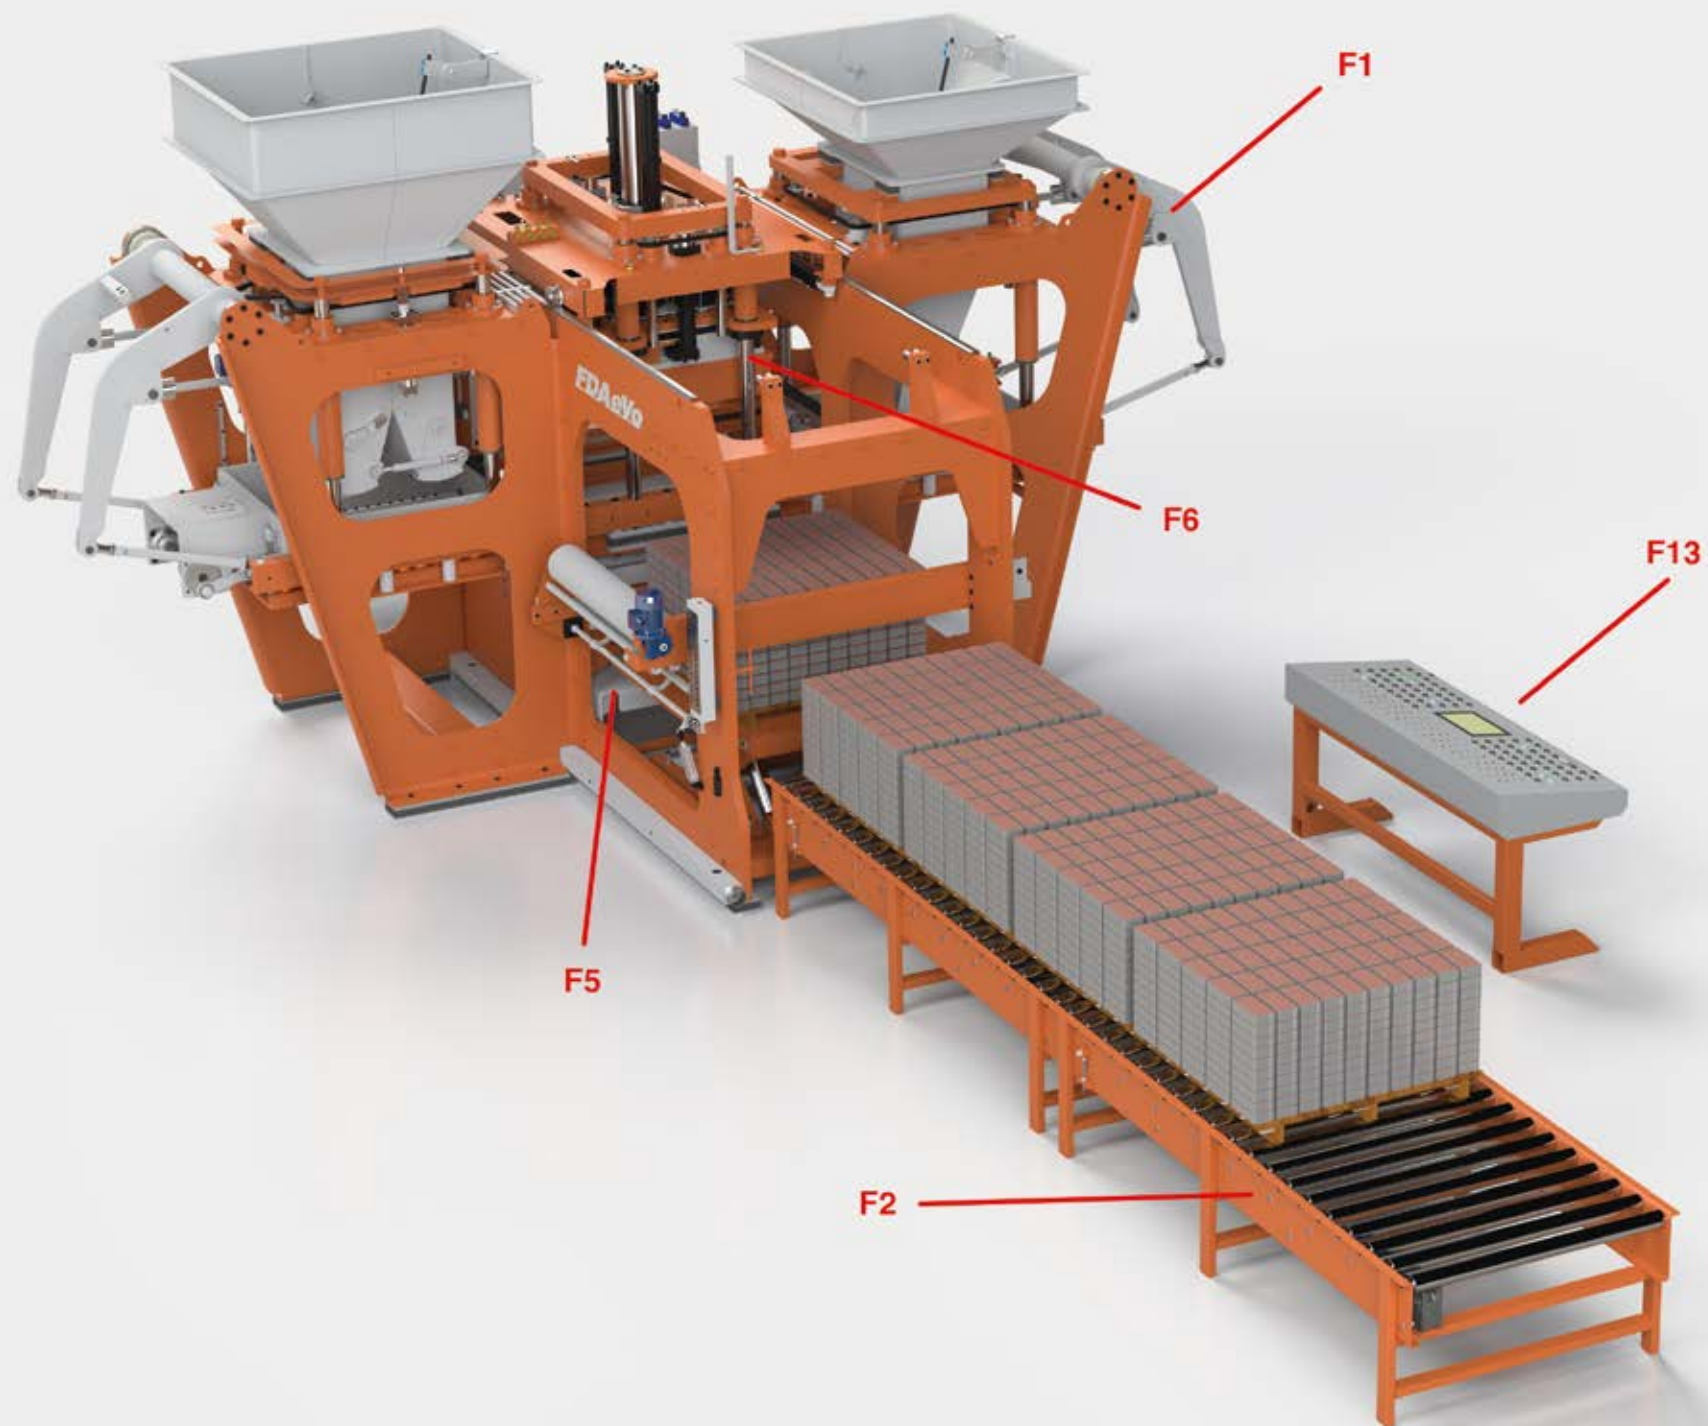



ESQUEMA CONFIGURAÇÃO TYPE “1”

[illegible]

VIBRO-PRENSAS NESSA CONFIGURAÇÃO

SÉRIE FDA

